



Automatika

MERAČ TEMPERATURE

MT-pt

7.07

NAMENA

Uređaj **MT-pt** se koristi za merenje temperature preko otporničke sonde pt-100.

Merenje temperature vrši se savremeno koncipiranim elektronskim kolima i to:

- izvor za napajanje,
- merni most,
- pojačivač,
- izlaz za eksterni instrument.


Izlaz za eksterni instrument je standardni linearizovani signal 0-10 mA.

Davač temperature je sonda Pt-100.

Pokazni instrument je graduisan u želejnom opsegu temperature.


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Pomoćni napon: 231 V, 50 Hz
- Potrošnja sopstvenih krugova: 10 VA
- Otporni davač: Pt-100 DIN
- Klasa tačnosti: 1,5
- Merno područje(po želji): 0 ÷ 200 °C

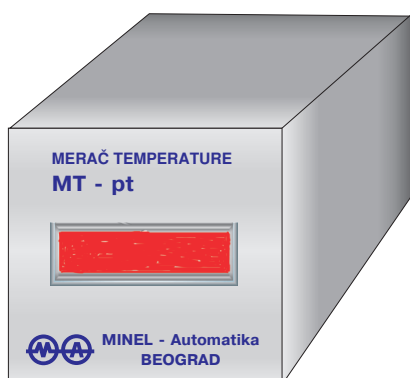


**MERAČ
TEMPERATURE** MT-pt

BLOK ŠEMA I NAČIN POVEZIVANJA

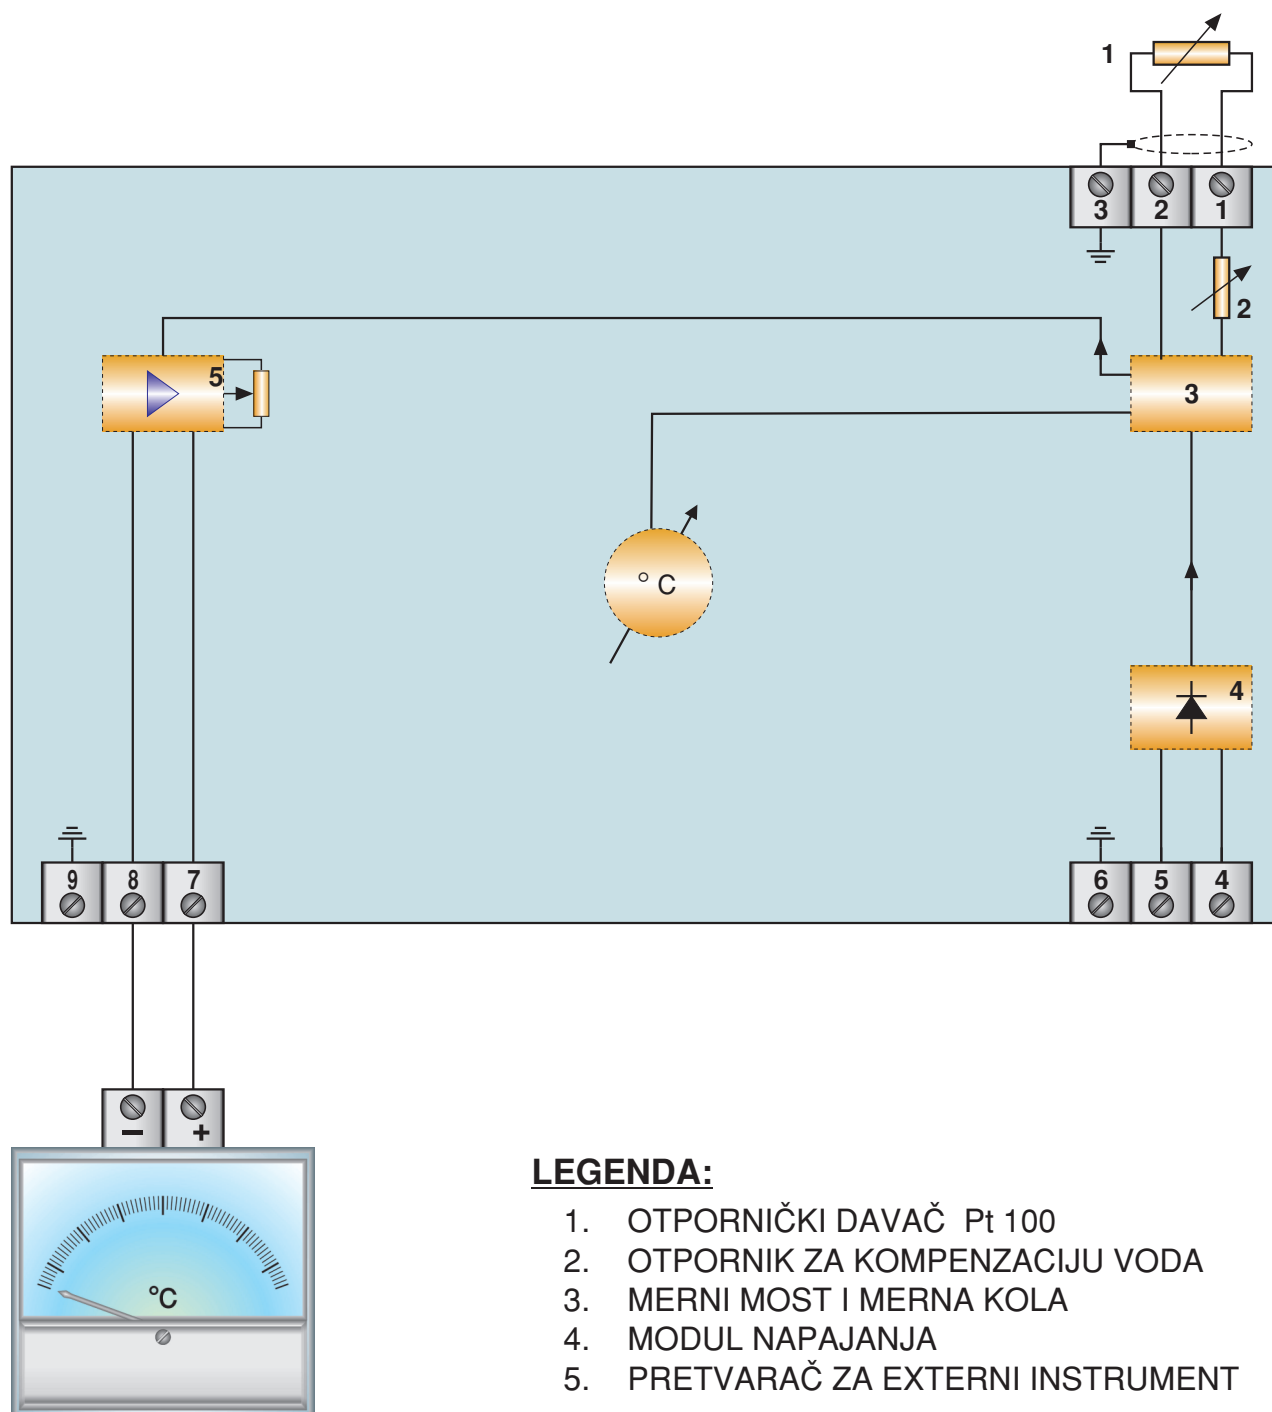

UGRADNE DIMENZIJE

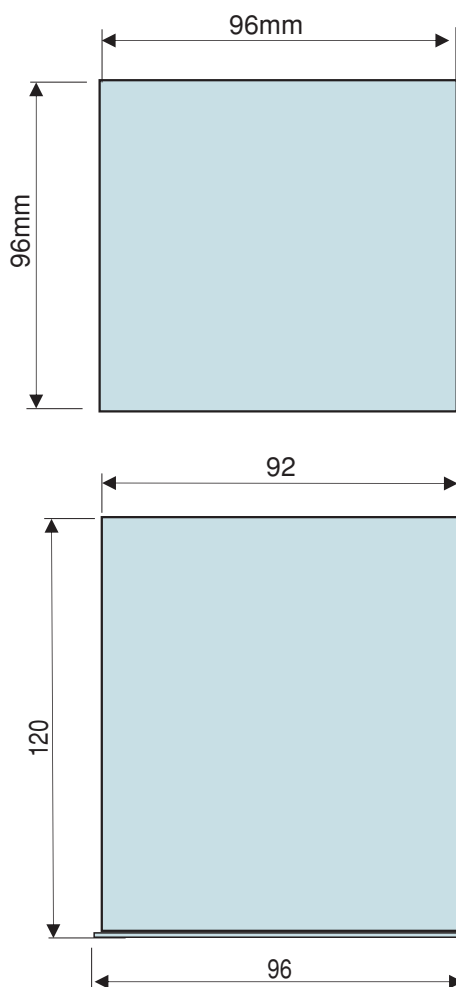

UPUTSTVO ZA NARUČIVANJE

MT - pt →

MERNO PODRUČJE (OPSEG)1

NAPAJANJE2

MAKS. STRUJA I NAPON IZLAZNIH RELEJA3

DODATNI INSTRUMENT4

OTPORNA SONDA Pt 1005

